

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
Ul. Kolejowa nr 1 a
32-310 Jaroszewiec

Jaroszewiec, dnia 03.07.2020r.

Nr sprawy: ZP.I.2.224/06/20

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zadaniu pn.: **Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu -ZP.I.2.224/06/20**

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmian treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. Zmian wynikających z Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

- 1) Zmiany zapisów sekcji IV.6.2.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ:

1) Na pierwszej stronie SIWZ:

Było zapisane:

„Termin składania ofert: 07 lipiec 2020r. godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert : 07 lipiec 2020r. godz. 12:15.”

Jest zapisane:

„Termin składania ofert: 09 lipiec 2020r. godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert : 09 lipiec 2020r. godz. 12:15.”

2) W sekcji VII pkt. 11) SIWZ:

Było zapisane:

„nazwa i adres Wykonawcy
Numer telefonu

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
” Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu ”



- nie otwierać przed dniem 07.07.2020 roku, godz. 12:15”

Jest zapisane:

„nazwa i adres Wykonawcy

Numer telefonu

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

” Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji

im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu -ZP.I.2.224/06/20”

- nie otwierać przed 09.07.2020 roku, godz. 12:15”

W sekcji VIII pkt.1 SIWZ:

Było zapisane:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kolejowej nr 1 a, w Jaroszowcu – sekretariat - Dziennik podawczy, Budynek Administracji, do dnia 07.07.2020r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt VII.11 SIWZ

Jest zapisane:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kolejowej nr 1 a, w Jaroszowcu – sekretariat - Dziennik podawczy, Budynek Administracji, do dnia 09.07.2020r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt VII.11 SIWZ

W sekcji VIII pkt. 4 SIWZ:

Było zapisane:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 203, I piętro Budynek Administracji, w dniu 07.07.2020r. o godzinie 12:15.

Jest zapisane:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 203, I piętro Budynek Administracji, w dniu 09.07.2020r. o godzinie 12:15.

II. Zmian wynikających z opisu przedmiotu zamówienia:

1) W Załączniku nr 1A - do SIWZ – Specyfikacja techniczna - Opis przedmiotu zamówienia

Łóżko szpitalne czterosegmentowe - 50 szt

Było zapisane

12.	Długość leża z materacem min. 2000 mm
13.	Szerokość leża z materacem min. 850 mm

Jest zapisane

12.	Długość leża z materacem min 1900 mm
13.	Szerokość leża z materacem min. 800 mm

2) W Załączniku nr 1B - do SIWZ – Specyfikacja techniczna - Opis przedmiotu zamówienia

Łóżko szpitalne czterosegmentowe - 10 szt

Dodatkowo funkcja Trendelenburga i anty -Trendelenburga

Było zapisane

12.	Długość leża z materacem min. 2000 mm
13.	Szerokość leża z materacem min. 850 mm

Jest zapisane

12.	Długość leża z materacem min 1900 mm
13.	Szerokość leża z materacem min. 800 mm

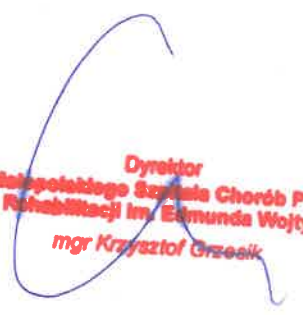
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu , w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4, 4 A ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

w imieniu Zamawiającego

Załączniki:

- 1) zmieniony Załącznik nr 1A do SIWZ,
- 2) zmieniony Załącznik nr 1B do SIWZ,


Dyrektor
Miejskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Woźniaka
mgr Krzysztof Grzesik

Załącznik nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 03 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja techniczna

Typ model			
Producent			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji			
Opis przedmiotu zamówienia			
Łóżko szpitalne czterosegmentowe - 50 szt.			
Lp.	Parametry techniczno-eksploatacyjne	Wartość wymagana	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)*
1	2	3	4
1.	Łóżko szpitalne czterosegmentowe wykonane z profili stalowych, malowane farbą z jonem srebra o właściwościach antybakteryjnych, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.	Tak/Podać	
2.	Łóżko wyposażone w minimum dwa koła z indywidualną blokadą i blokadą kierunkową	Tak	
3.	Średnica kół jezdnych min. 125mm	Tak/Podać	
4.	Łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża przy pomocy siłownika elektrycznego sterowane za pomocą pilota w zakresie minimalnym 365-810 mm,	Tak/Podać	
5.	Regulacja kąta uniesienia segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0-70°, sterowane za pomocą pilota elektrycznego	Tak/Podać	
6.	Regulacja kąta uniesienia segmentu uda w zakresie min. 0-35°, sterowane za pomocą pilota elektrycznego	Tak/Podać	



7.	Regulacja kąta uniesienia segmentu podudzia w zakresie min. 0-20° sterowane za pomocą pilota elektrycznego	Tak/Podać	
8.	Łóżko wyposażone w funkcję autoregresji oparcia pleców 105 mm +/-15 mm	Tak/Podać	
9.	Szczyty łóżek wykonane z płyty HPL lub ABS	Tak/Podać	
10.	Całkowita długość łóżka nie mniejsza niż 1900 mm i nie większa niż 2160 mm	Tak/Podać	
11.	Całkowita szerokość łóżka nie mniejsza niż 800mm i nie większa niż 970 mm	Tak/Podać	
12.	Długość leża z materacem min. 1900 mm	Tak/Podać	
13.	Szerokość leża z materacem min.800 mm	Tak/Podać	
14.	Maksymalne obciążenie łóżka minimum 200 kg zapewniające bezpieczną hospitalizację dorosłego pacjenta	Tak/Podać	
15.	Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat	Tak	
16.	Wyposażenie dodatkowe : bariery boczne malowane farbą z jonem srebra , składane wzdłuż leża, wysięgnik ręki z podwieszka, statyw na kroplówki przyłóżkowe, materac szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym – min. 10 cm	Tak/Podać	
17.	Materac przeciwodleżynowy	Tak/Podać	
1 szt	Cena netto	VAT	Cena brutto

Uwaga:

Nie spełnienie któregośkolwiek parametru techniczno-eksploatacyjnego spowoduje odrzucenie oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

.....
Data, miejscowość,

.....
Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub

str. 2

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie o ile z treści
pełnomocnictwa wynika upoważnienie do
złożenia stosowanego oświadczenia)
opcjonalnie pieczęć Wykonawcy

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego formularza.

Załącznik nr 1B do SIWZ po zmianie z dnia 03 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1B do SIWZ – Specyfikacja techniczna

Typ model			
Producent			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji			
Opis przedmiotu zamówienia			
Łóżko szpitalne czterosegmentowe - 10 szt.			
Dodatkowo funkcja Trendelenburga i anty -Trendelenburga			
Lp.	Parametry techniczno-eksploatacyjne	Wartość wymagana	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)*
1	2	3	4
1.	Łóżko szpitalne czterosegmentowe wykonane z profili stalowych, malowane farbą z jonem srebra o właściwościach antybakteryjnych, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.	Tak/Podać	
2.	Łóżko wyposażone w minimum dwa koła z indywidualną blokadą i blokadą kierunkową	Tak	
3.	Średnica kół jezdnych min. 125mm	Tak/Podać	
4.	Łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża przy pomocy siłownika elektrycznego	Tak/Podać	

	sterowane za pomocą pilota w zakresie minimalnym 365-810 mm,		
5.	Regulacja kąta uniesienia segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0-70°, sterowane za pomocą pilota elektrycznego	Tak/Podać	
6.	Regulacja kąta uniesienia segmentu uda w zakresie min. 0-35°, sterowane za pomocą pilota elektrycznego	Tak/Podać	
7.	Regulacja kąta uniesienia segmentu podudzia w zakresie min. 0-20° sterowane za pomocą pilota elektrycznego	Tak/Podać	
8.	Łóżko wyposażone w funkcję autoregresji oparcia pleców 105 mm +/-15 mm	Tak/Podać	
9.	Szczyty łóżek wykonane z płyty HPL lub ABS	Tak/Podać	
10.	Całkowita długość łóżka nie mniejsza niż 1900 mm i nie większa niż 2160 mm	Tak/Podać	
11.	Całkowita szerokość łóżka nie mniejsza niż 800mm i nie większa niż 970 mm	Tak/Podać	
12.	Długość leża z materacem min. 1900 mm	Tak/Podać	
13.	Szerokość leża z materacem min.800 mm	Tak/Podać	
14.	Maksymalne obciążenie łóżka minimum 200 kg zapewniające bezpieczną hospitalizację dorosłego pacjenta	Tak/Podać	
15.	Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat	Tak	
16.	Wyposażenie dodatkowe : barierki boczne malowane farbą z jonem srebra , składane wzdłuż leża, wysięgnik ręki z podwieszka, statyw na kroplówki przyłóżkowe, materac szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym – min. 10 cm	Tak/Podać	
17.	Materac przeciwoleżynowy	Tak/Podać	



18.	Dodatkowo funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowane za pomocą pilota elektrycznego		
1 szt	Cena netto 1 szt	VAT	Cena brutto

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru techniczno-eksploatacyjnego spowoduje odrzucenie oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp)

.....
Data, miejscowość,

.....
Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia) opcjonalnie pieczęć Wykonawcy

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego formularza.