

Nr sprawy: ZP.I.2.224/17/20

Jarosław, dnia 20.01.2020r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Zakup urządzenia do pozyskiwania tlenu z powietrza (koncentrator tlenu) wraz z pomieszczeniem kontenerowym, wymianą stacji redukcji oraz dokończenie rozprowadzenia pozostałych punktów tlenu
Nr sprawy: ZP.I.2.224/17/20

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z prowadzonym postępowaniem zostały zadane następujące pytania:

PYTANIE nr 1. Pkt 3 SIWZ określa, że przedmiotem zamówienia, jest wyrób medyczny klasy II b co jest zgodne z PFU, a w części opisowej, podana jest również podstawa prawna wg której należy wykonać zadanie.

W dalszej części SIWZ, zadanie zostało zamienione na wyrób budowlany i Zamawiający wymaga dokumentów związanych z wyrobem budowlanym.

Informuję, że zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych system koncentratora tlenu jest wyrobem medycznym, w związku z tym proszę o informację czy ma to być wyrób medyczny jak określa PFU czy też wyrób budowlany jak określa SIWZ?

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 1

Informujemy, że koncentrator tlenu i instalacja gazów medycznych jest głównym, ale nie jedynym elementem przedsięwzięcia budowlanego ujętego w SIWZ. Własności koncentratora i instalacji gazów medycznych powinny spełniać wymagania określone dla wyrobu medycznego. Jednocześnie, tak jak i pozostałe elementy przedsięwzięcia budowlanego opisanego w PFU, powinny być zgodne z zasadami i wymogami określonymi w Prawie Budowlanym i Warunkami Technicznymi, jakimi Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie.

PYTANIE nr 2. Pkt 4 SIWZ termin wykonania zadania określa się na 84 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Proszę o uściślenie na 84 dni robocze i uwzględnienie tego umowie par 3 ppkt 1 str 21

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis w Pkt.4 SIWZ.

PYTANIE nr 3. Pkt 5.3.1.2.2 Zamawiający żąda uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

PYTANIE nr 4. Pkt 6.3.2.2 Zamawiający żąda uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

W/w uprawnienia nie dotyczą instalacji gazów medycznych proszę o określenie jakich uprawnień żąda zamawiający, aby były zgodne z PFU i Ustawą o Wyrobach Medycznych?

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 3

Informujemy, że koncentrator tlenu i instalacja gazów medycznych jest głównym, ale nie jedynym elementem przedsięwzięcia budowlanego ujętego w SIWZ. Własności koncentratora i instalacji gazów medycznych powinny spełniać wymagania określone dla wyrobu medycznego. Jednocześnie, tak jak i pozostałe elementy przedsięwzięcia budowlanego opisanego w PFU, powinny być zgodne z zasadami i wymogami określonymi w Prawie Budowlanym i ich zaprojektowanie, wykonanie i odbiór wymagają uczestnictwa i nadzoru osób o właściwych, określonych przez to prawo, uprawnieniach. Wykonawca instalacji gazów medycznych wraz z zastosowanymi urządzeniami stanowiącymi wyrób medyczny powinien, zgodnie z zapisami w normie PN-EN ISO 7396-1:2016, przygotować i przekazać Zamawiającemu certyfikat na zgodność wykonanej instalacji z wymaganiami dotyczącymi wyrobu medycznego oraz zgodności z normą PN-EN ISO 7396-1:2016.

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 4

Odowiedź taka jak w pkt 3.

UMOWA

PYTANIE nr 5. Par.1 pkt.12 Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.

Czy dokumentacja powinna być zgodna z Prawem Budowlanym czy z Ustawą o Wyrobach Medycznych?

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 5

Dokumentacja powinna być zgodna z Prawem Budowlanym i, w zakresie gazów medycznych, z Ustawą o Wyrobach Medycznych.

PYTANIE nr 6. Par.8.

Proszę o rozliczenie II etapu w dwóch transzach.

Transza I 80% wartości po dostarczeniu urządzeń na teren Szpitala.

Transza II pozostałe 20% po zakończeniu robót.

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 6

Zamawiający wyraża zgodę,

PYTANIE nr 7. Par.9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy..

Proszę o formę weksla własnego, proszę o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 7

Zamawiający zastrzega w pkt. 15 Siwz, iż: „Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.”

Zamawiający jednak na prośbę uczestnika postępowania **dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla**, pod warunkiem jednak spełnienia warunków określonych w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tzn. **weksel winien być wniesiony z poleceniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**.

PYTANIE nr 8. Par.17 .

dodatkowo proszę umieścić zapis o wystąpieniu siły wyższej.

„Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za zwłokę w wykonaniu lub niewykonanie własnych zobowiązań wynikających z Umowy, o ile taka zwłoka w wykonaniu lub niewykonanie będą spowodowane przez czynniki niezależne od woli Stron, w szczególności wywołane zdarzeniami siły wyższej, tj. zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, a któremu skutkom pomimo zachowania należytej staranności nie można było zapobiec.

Zaistnienie zdarzeń niezależnych od woli Stron charakterze siły wyższej, które uniemożliwiłyby Stronie częściowo lub całkowicie spełnienie obowiązków umownych, spowoduje zawieszenie wykonywania uniemożliwionych tych zobowiązań w okresie trwania i zakresie skutków tego zdarzenia.

Gdyby takie zdarzenie miało miejsce, Strona nim dotknięta zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia skutków i następstw tego zdarzenia oraz do natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o jego wystąpieniu a także zakończeniu. Umowa zostaje przedłużona o okres trwania wyżej określonego zdarzenia.

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 8

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

PYTANIE nr 9. Zał.6 do SIWZ

Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych.

Czy referencji z realizacji dostaw lub montażu systemów koncentratorów tlenu?

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga wykazu robót w zakresie realizacji i uruchomienia systemu gazów medycznych zasilanych koncentratorem tlenu wraz z całą konieczną infrastrukturą.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu w sposób wskazany w załączniku do niniejszych odpowiedzi na pytania.

PYTANIE nr 10. Zał.3A Gwarancja.

To nie jest konserwacja. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie urządzeń pod Warunkiem że:

Zamawiający będzie posiadał konserwatora, który będzie zajmował się eksploatacją urządzeń.

Zamawiający w okresie gwarancji będzie ponosił koszty za materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń.

Proszę o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 10

Tak – Zamawiający będzie dysponował konserwatorami, którzy będą zajmować się eksploatacją urządzeń, będących przedmiotem zamówienia i w okresie gwarancji oraz rękojmi będzie ponosił koszty za materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń. Wraz z podpisaną umową Szpital udostępni listę pracowników do przeszkolenia, która będzie stanowić Załącznik do zawartej umowy (lub protokołu końcowego robót).

Instalacja wewnętrzna.

PYTANIE nr 11.



Proszę o udostępnienie inwentaryzacji instalacji gazów medycznych Szpitala z uwzględnieniem pomieszczeń, w których mają być zamontowane punkty tlenowe.

Inwentaryzację proszę udostępnić elektronicznie w formacie DWG.

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 11

Zamawiający udostępnia do wglądu posiadaną dokumentację instalacji gazów medycznych Szpitala elektronicznie w formacie PDF tj:

- 1) Rysunek nr 1 – rzut pawilonu PG
- 2) Rysunek nr 2 – projekt wykonawczy, rozwinięcie instalacji
- 3) Rysunek nr 3 – przekrój A-A pawilon PG
- 4) Rysunek nr 4 – rzut I piętra budynku głównego

PYTANIE nr 12.

Proszę o podanie ile należy dostarczyć dozowników tlenu ?

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 12

Zamawiający aktualnie dysponuje wymaganą ilością dozowników tlenu.

PYTANIE nr 13. Proszę o informację ile docelowo będzie punktów poboru tlenu?

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 13

Ogółem punktów tj. gniazd wejściowych do dozowników tlenu typu AGA będzie 156 gniazd. Natomiast w przypadku 4 gniazd niezbędny jest podwójny rozgałęźnik. W efekcie planuje się, aby ogółem 160 łóżek miało bezpośredni dostęp do tlenu.

PYTANIE nr 14. Ilu pacjentów będzie jednocześnie korzystało z tlenu

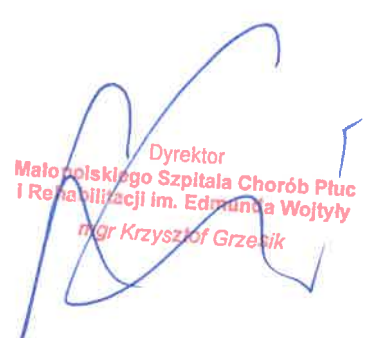
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 14

Ilość pacjentów jednocześnie korzystających z podawanego tlenu i określenie współczynnika jednoczesności jego zużycia zostanie określona wspólnie przez Projektanta i Zamawiającego w ramach prac koncepcyjnych. Aktualnie liczba pacjentów korzystających jednocześnie z instalacji tlenowej wynosi ok. 25 osób.

Zamawiający informuje, iż zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert :

Termin złożenia ofert upływa w dniu **25 stycznia 2021 r.**, godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: **25 stycznia 2021 r.**, godz. 12:30


Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik